


Nom du client	Désignation	Quantité
ITD	FILTRE VERT A	1
N° de commande interne	N° de commande client	Date de réalisation
		18/01/2023
n°du RUN	Spécifications	Face Traitée
-	[220 - 2400 nm] @ i=0°	-

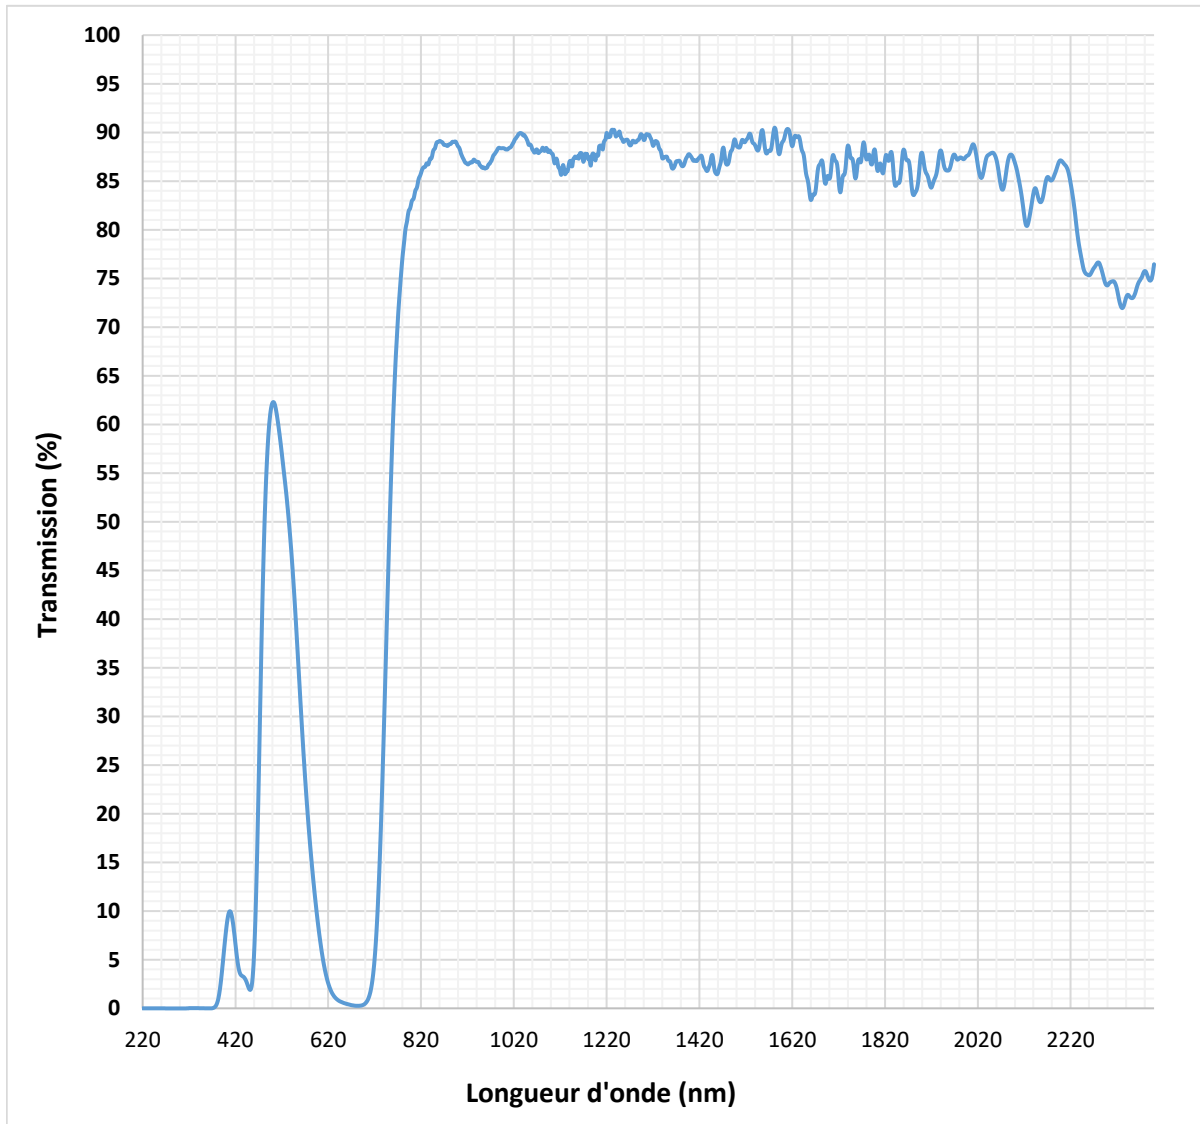

Spectrophotomètre	Module	Incidence
Perkin Elmer Lambda 1050+	2D Detector	0°
Substrat	Test d'adhérence	Test d'abrasion
FILTRE VERT	-	-

Date du Procès Verbal	18/01/2023
Visa du contrôleur	MR